

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

RA.RU.311463

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

## О ПОВЕРКЕ № 5973-01

Действительно до  
6 октября 2021 г.

Средство измерений *Весы неавтоматического действия GR, мод. GR-120 Рег. № 57514-14*

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер *14249653*

в составе -----

номер знака предыдущей поверки -----

поверено *в полном объеме*

наименование величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с *приложением ДА "Методика поверки весов" ГОСТ OIML R 76-1-2011*

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: *3.1.ZBA.0011.2012*

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: *температура 22,3°C, относительная влажность 48,6%, атмосферное давление 742мм рт.ст.*

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной(периодической) поверки признано пригодным к  
применению ненужное зачеркнуть

Знак поверки



Руководитель  
отдела

Епишев Сергей Сергеевич

Поверитель


Винокурова Елена Анатольевна

Дата поверки  
*7 октября 2020 г.*

При повторной поверке предъявление свидетельства обязательно

00011563

**МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И (ИЛИ) ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ**

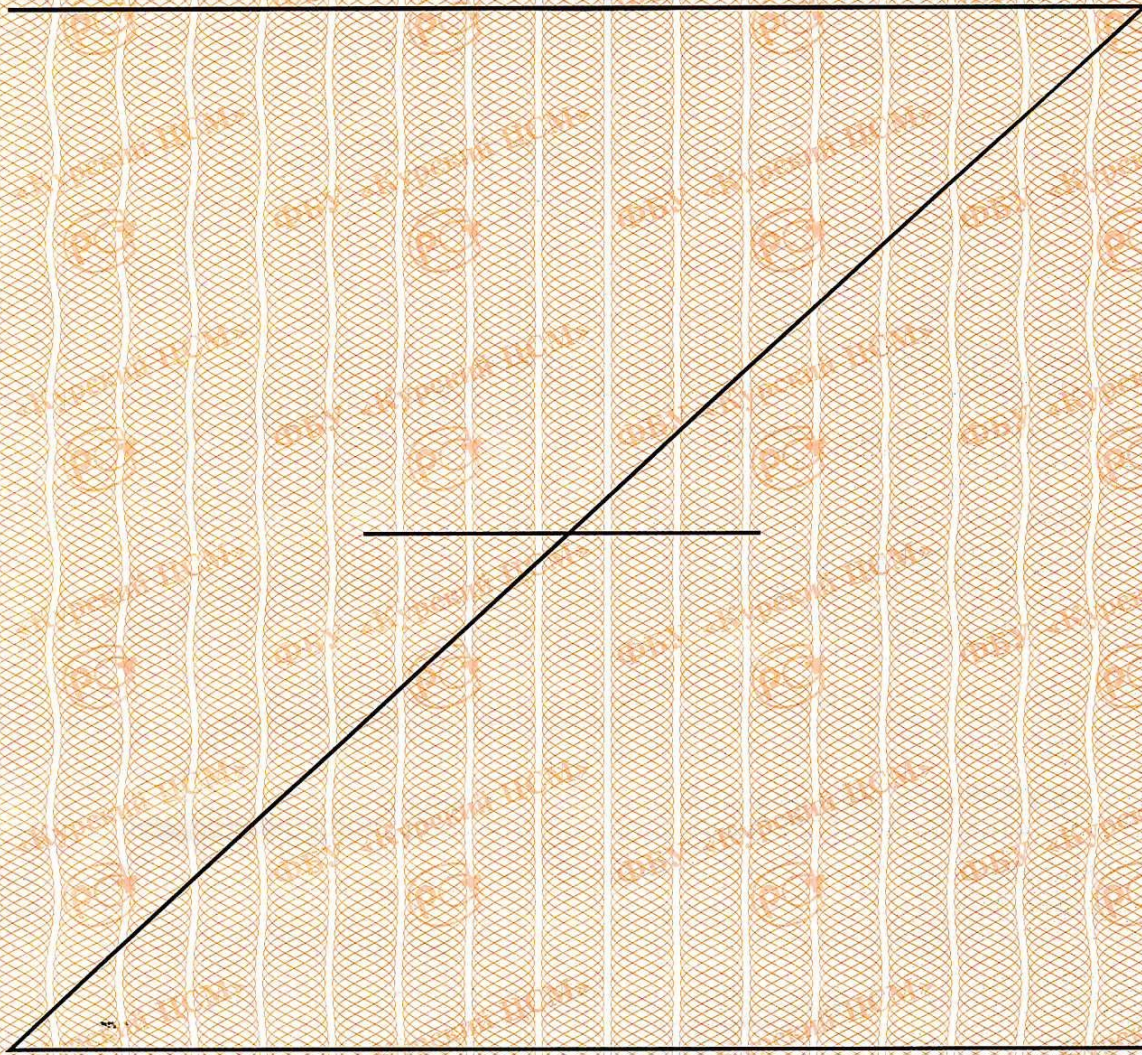

принадлежит *ФГБОУ ВО Курская ГСХА ИНН 4629029121*